


Προς
RAYMED Ε.Π.Ε.
Fax No. : 210.6800350



ΤΣΟΧΑ 5
115 21 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8701 600
FAX: 210 8701 601
email: info@depanom.gr
www.depanom.gr

136588/27.06.13

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

Γ.Α. (Απάντηση στο Γ.Α. 136477) σχετ. /25.06.13

26.06.13

Θέμα : Διευκρινήσεις επί των προδιαγραφών για την προμήθεια - εγκατάσταση Συστήματος PET-CT και διαμόρφωση χώρου υποδοχής του στο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο».

Σε απάντηση της ανωτέρω επιστολής, σας ενημερώνουμε πως βασική αρχή στους διαγωνισμούς της ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε., είναι η αποδοχή προσφορών που είναι τεκμηριωμένα ισοδύναμες προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών. Στο πλαίσιο αυτό, σας γνωρίζουμε ανά περίπτωση τα ακόλουθα :

1. Παράγραφος Προδιαγραφών 2.11

Η δυνατότητα μεταφοράς και λειτουργίας των παρελκομένων, «automatic dispenser» και «dose calibrator» σε άλλη θωρακισμένη εστία του ίδιου τύπου με την προσφερόμενη, κρίνεται αποδεκτή στο πλαίσιο του πνεύματος των προδιαγραφών του διαγωνισμού.

2. Παράγραφος Προδιαγραφών 2.1.4,


Η πρόβλεψη θωρακισμένου κάδου μη ενσωματωμένου στη θωρακισμένη εστία, θεωρείται ισοδύναμη και αποδεκτή στο πλαίσιο του πνεύματος των προδιαγραφών του διαγωνισμού.

3. Παράγραφος Προδιαγραφών 2.2.3

Διευκρινίζεται ότι το πνεύμα της απαίτησης των προδιαγραφών «programmable number and volume of rinsing cycles», καλύπτεται ισοδύναμως από τη δυνατότητα ελέγχου μέσω τηλεχειριστηρίου των επαναλήψεων και συνακόλουθα του συνολικού όγκου έκπλυσης.

4. Παράγραφος Προδιαγραφών 3.1.4

Οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι οι διαστάσεις της επιφάνειας εργασίας. Στο πλαίσιο πάντως της τεκμηριωμένης ισοδυναμίας προς τις απαιτήσεις των προδιαγραφών, που προαναφέρθηκε, σημειώνουμε πως ουσιαστική παράμετρο δεν αποτελούν οι επιμέρους διαστάσεις αλλά το συνολικό απαιτούμενο εμβαδό της επιφάνειας εργασίας, το οποίο υπερκαλύπτεται από την εστία που διαθέτει η εταιρεία σας. Σε κάθε περίπτωση, όπως διαπιστώσαμε από τον ιστότοπο της κατασκευάστριας εταιρείας την οποία εκπροσωπείτε, οι διαστάσεις της εστίας που αφορούν στο τελευταίο μοντέλο της γραμμής παραγωγής, που αντιστοιχεί στις απαιτήσεις των προδιαγραφών, είναι συμβατές με τις διαστάσεις των προδιαγραφών της Διακήρυξης και επομένως δεν υφίσταται πρόβλημα συμμετοχής της εταιρείας σας.

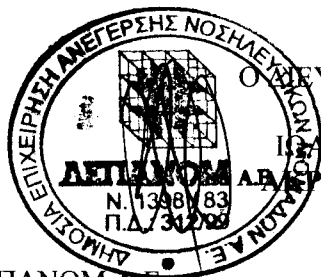

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κοινοποίηση :

1. Πρόεδρο Δ.Σ.
2. Διευθύνοντα Σύμβουλο ΔΕΠΑΝΟΜ Α.Ε.
3. Διεύθυνση Έργων
4. Μονάδα Μελετών